



métropole  
ROUEN NORMANDIE

**APPEL A CANDIDATURE  
DANS LE CADRE DE LA VENTE D'APPAREILS  
DE LA BAIE D'ANALYSE DU FOUR  
D'INCINERATION DE SAINT-AUBIN-LES-  
ELBEUF**

## CONTEXTE

La Métropole Rouen Normandie a pris la décision d'arrêter son installation d'incinération des boues située sur la station d'épuration de Saint-Aubin-lès-Elbeuf et de céder les appareils de mesures en ligne qui ne seront plus utilisés sur cet ouvrage.

Le présent appel à candidature vise à recueillir des propositions d'acquisition de 12 appareils mis en vente :

Appareil 1 : Analyseur COv

Appareil 2 : Analyseur laser hcl h2O

Appareil 3 : Analyseur 4 gaz (CO / O2 / Nox / SO2)

Appareil 4 : Analyseur SO2 (redondant)

Appareil 5 : Analyseur O2 cheminée

Appareil 6 : Analyseur O2 (après échangeurs)

Appareil 7 : Analyseur 2700 O2 + CO Carneau

Appareil 8 : Groupe froid baie d'analyse

Appareil 9 : Générateur d'hydrogène

Appareil 10 : Préleveur de PCDD/F

Appareil 11 : Mesure de débit des fumées

Appareil 12 : Analyseur de poussières

## DESCRIPTION DES APPAREILS

Appareil 1 : Analyseur COv

M&A

thermo FID type ES

N° de série : 4319920

Mise en service : 2006



Appareil 2 : Analyseur laser hcl h2O  
SERVOMEX  
2930  
N° de série : 4512  
Mise en service : 2018



Appareil 3 : Analyseur 4 gaz (CO / O2 / Nox / SO2)  
SERVOMEX  
4900  
N° de série : 23100318  
Mise en service : 2006



Appareil 4 : Analyseur SO2 (redondant)

SERVOMEX

4900

N° de série : 100555

Mise en service : 2020




Appareil 5 : Analyseur O2 cheminée

SERVOMEX

2700

N° de série : 3882

Mise en service : 2006

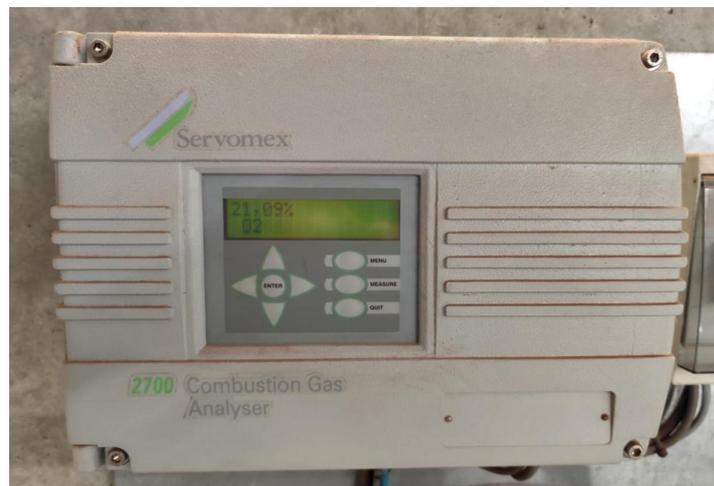


Appareil 6 : Analyseur O2 (après échangeurs)  
SERVOMEX  
2700  
Mise en service : 2006



Appareil 7 : Analyseur 2700 O2 + CO Carneau  
SERVOMEX  
Soft 2700 – CPO-07  
Mise en service : 2006



Appareil 8 : Groupe froid baie d'analyse  
Bühler technology  
RC 1.2+

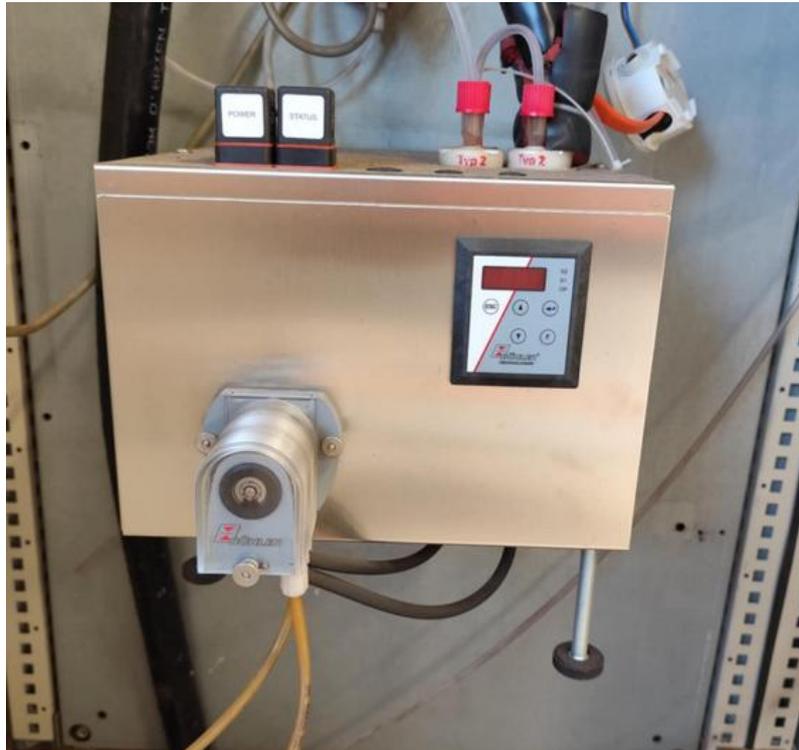

Appareil 9 : Générateur d'hydrogène  
FDGS



Appareil 10 : Préleveur de PCDD/F  
TECORA  
DECS  
Mise en service : 2015



Appareil 11 : Mesure de débit des fumées  
DURAG  
D-RX 250  
N° de série : 409762  
Mise en service : 2006



Appareil 12 : Analyseur de poussières  
SICK  
DH SP 100  
N° de série : 14128335



## CRITERES DE SELECTION

L'unique critère de sélection des offres retenu est le prix.

## DOSSIER DE CANDIDATURE

Pour concourir au présent appel à candidature, les candidats devront déposer un dossier de candidature constitué des éléments suivants :

- Nom commercial et dénomination sociale
- Nom et Prénom du représentant
- Adresse postale
- Coordonnées téléphoniques et électroniques
- Numéro de SIRET
- Code APE
- Offre financière contenant le prix détaillé par appareil et le prix total
- Date de reprise

Les dossiers complets sont à envoyer, avant la date de clôture de l'appel à candidature fixée au **vendredi 17 octobre 16h00**, par mail aux adresses suivantes :

- service technique : [julien.thys@metropole-rouen-normandie.fr](mailto:julien.thys@metropole-rouen-normandie.fr),  
[thomas.leroux@metropole-rouen-normandie.fr](mailto:thomas.leroux@metropole-rouen-normandie.fr)
- service administratif : [amelie.arnaudet@metropole-rouen-normandie.fr](mailto:amelie.arnaudet@metropole-rouen-normandie.fr)

## ENGAGEMENT DU CANDIDAT

Le candidat s'engage à démonter le matériel à sa charge.

Un Plan de Prévention sera à réaliser avec la Métropole avant l'intervention de démontage.